


640 lat
Rymanowa

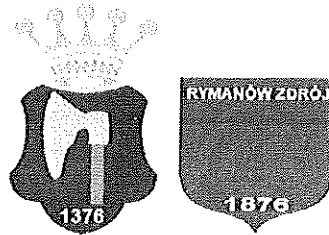

140 lat
Rymanowa Zdroju

GINA RYMANÓW

RIN.271.6.2016

Rymanów, dnia 08.06.2016r.

Strona internetowa Zamawiającego:
www.rymanow.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji monitoringu powietrza”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), przekazujemy pytanie otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź:

Pytanie 1 - dotyczy automatycznego analizatora pyłu zawieszonego.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga/potrzebuje ciągłych, równoległych pomiarów frakcji PM10 i PM2,5 czy też dopuszcza dostawę analizatora, który po skonfigurowaniu będzie mierzył tylko frakcję pyłu PM10, bądź tylko frakcję pyłu PM2,5 - w zależności od chwilowych potrzeb zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora bądź analizatorów mierzących równoległe stężenie PM10 i PM2,5. W przypadku gdy dostawca oferuje analizator mierzący jedynie jedną frakcję pyłu wymagane jest aby każdy dostarczony analizator posiadał głowice separacyjne zarówno PM10 jak i PM2,5. Zamawiający dopuszcza dostarczenie analizatora mierzącego jedynie PM10 równocześnie z analizatorem mierzącym jedynie PM2,5 jednak w przypadku gdy dany typ analizatora umożliwia wykonywanie również pomiaru stężenia drugiej frakcji pyłu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie akcesoria umożliwiające wykonanie dostarczonym analizatorem zarówno pomiaru stężenia PM10 jak i PM2,5.

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Fabianiec